旭ヘモダイアフィルタ性能評価
ABH-22PA
（ABH-21F,ABH-21Pとの比較）

大田姫野クリニック

富永　明博　　坂本　純平　　福村　宏

対象と方法

☞当院維持透析患者6名を対象とした.

年齢:61±2.8歳

透析歴:131.1±78.9カ月

☞ 透析条件

5時間前希釈オンラインHDF

QB:250ml/min　QF:200ml/min　tQD:700ml/min

☞使用したヘモダイアフィルタ

ABH-21F, ABH-21P, ABH-22PA

☞ 統計学的検定はTukey-Kramer法を用いた.

BUN, Cr, UA, P除去率

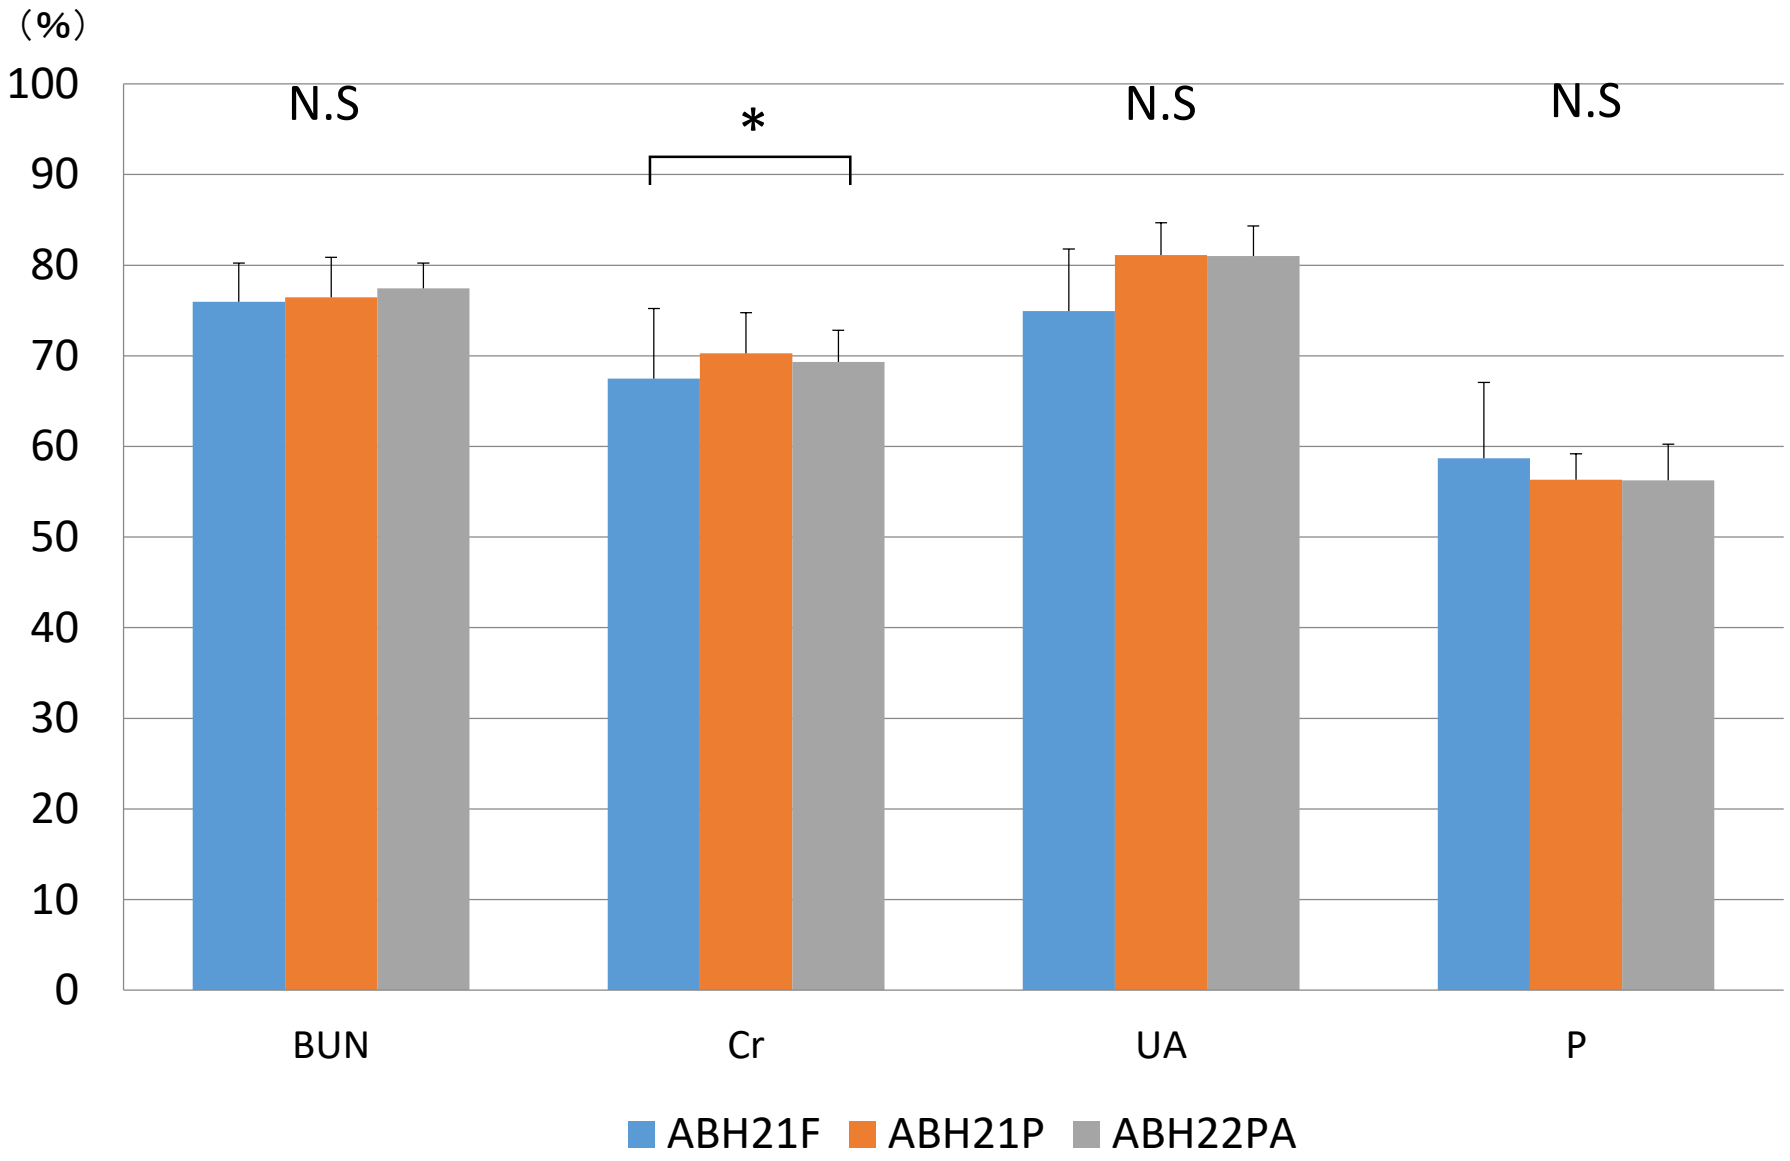

*P<0.05
**P<0.01

β2MG，α1MG除去率

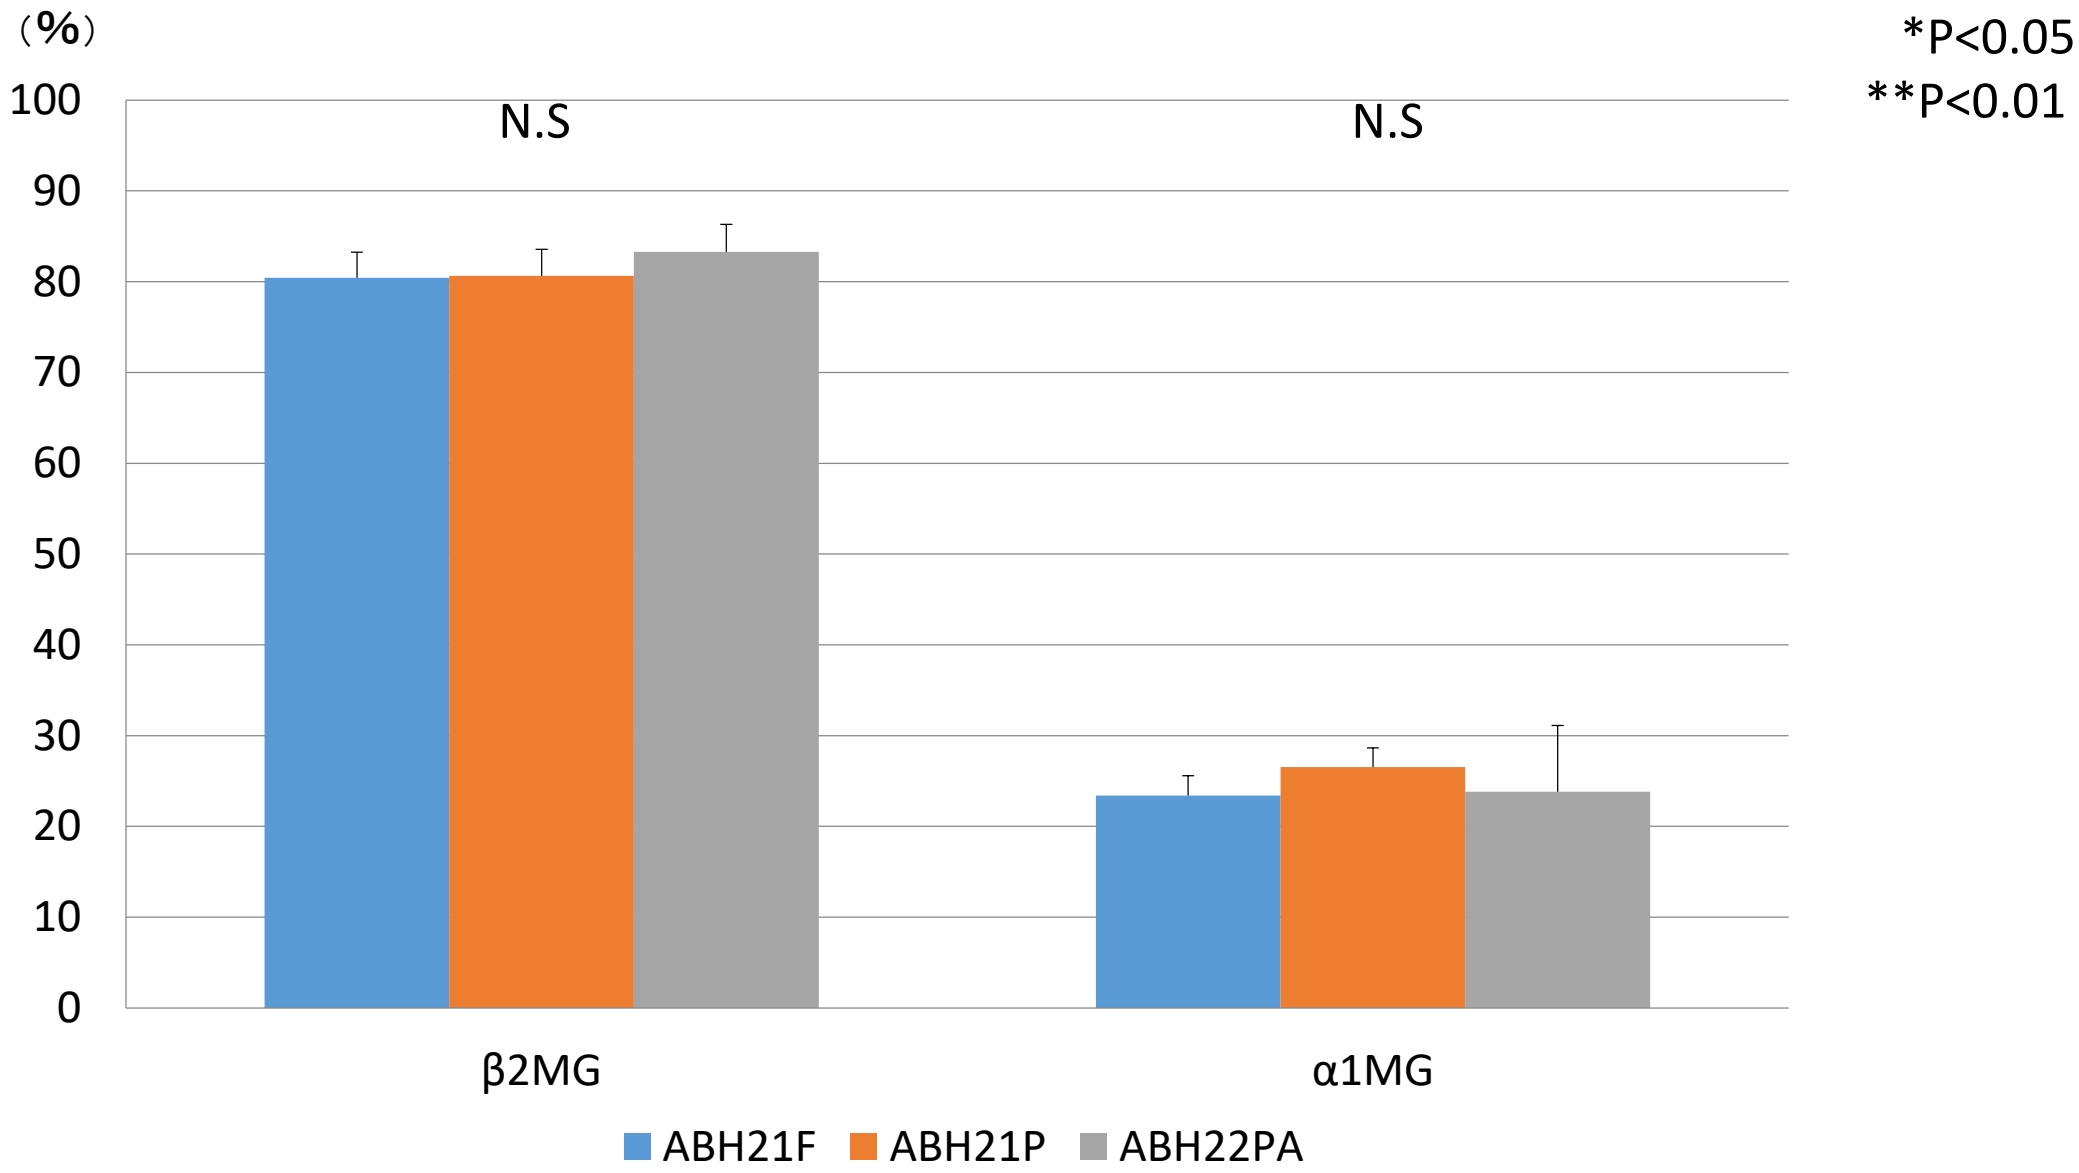

*P<0.05
**P<0.01

β2MG，α1MG除去量

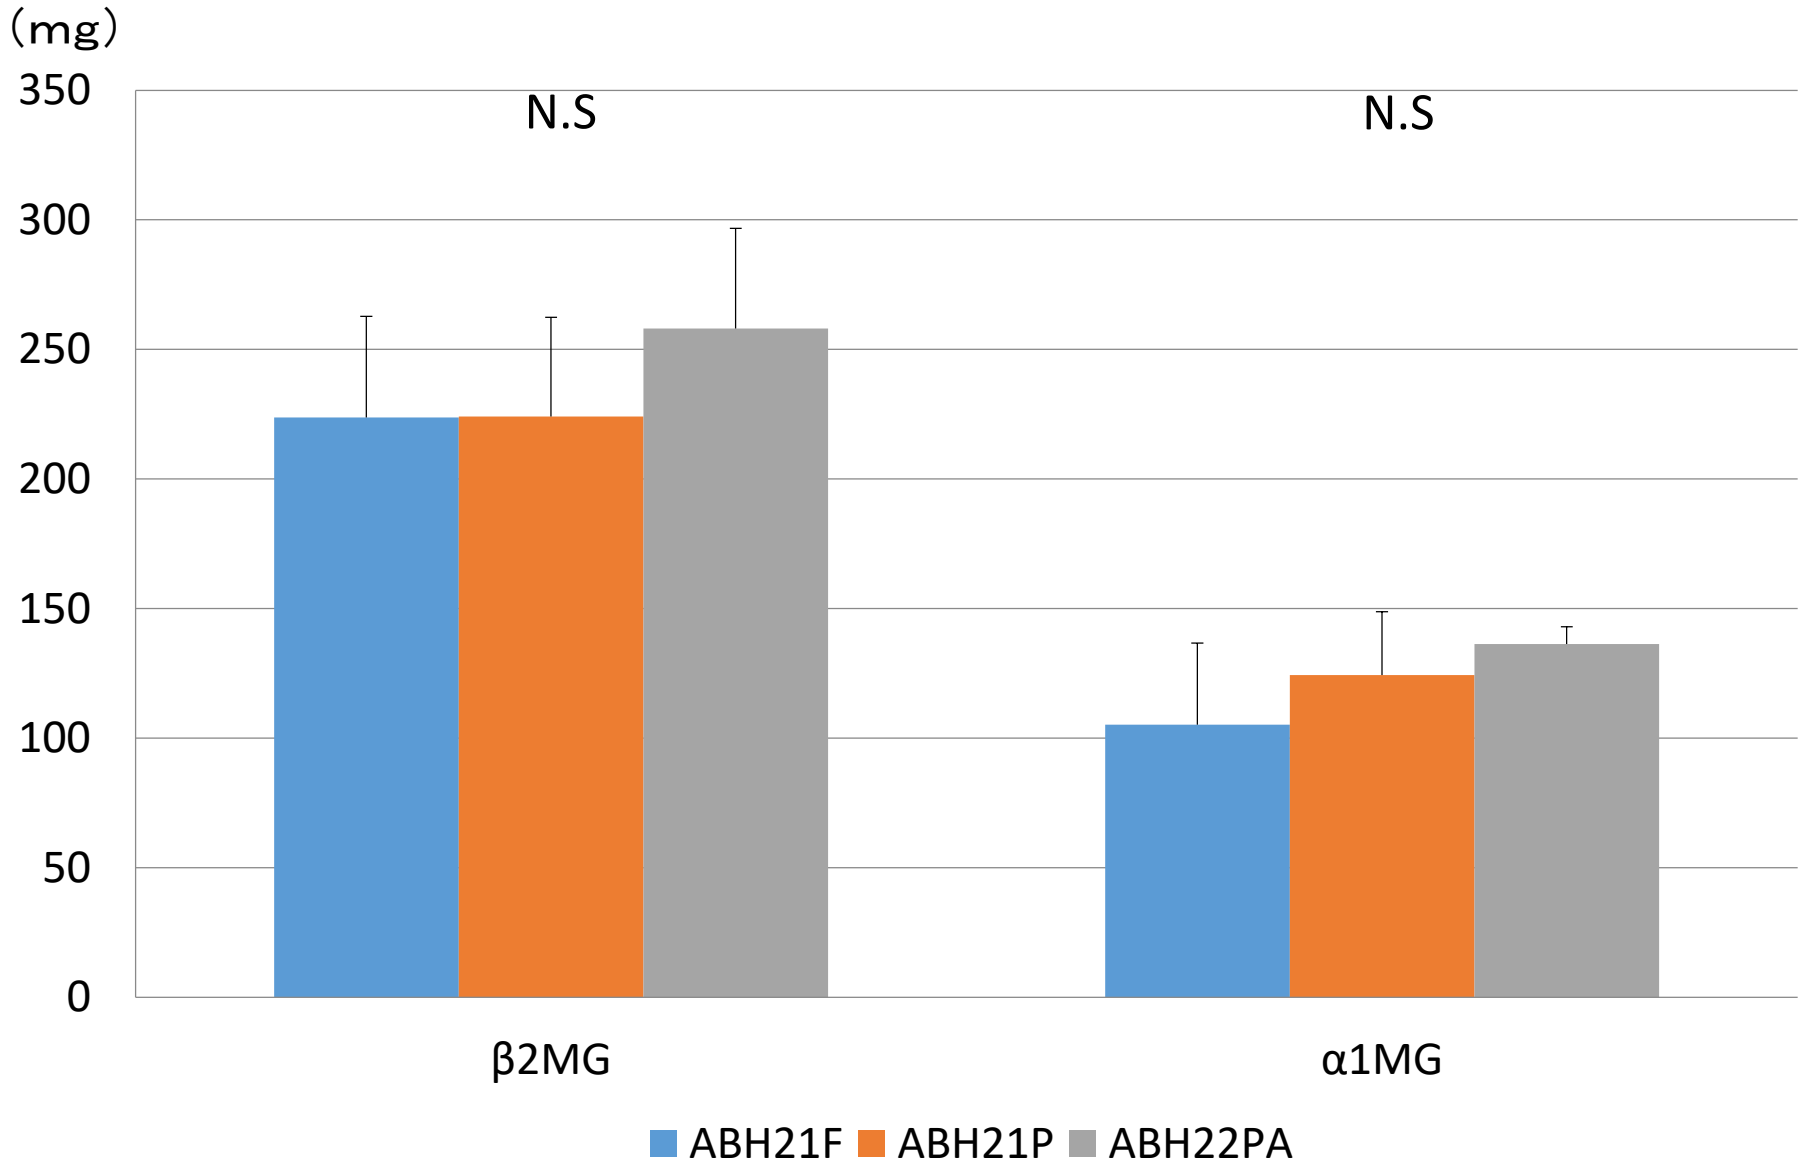

*P<0.05
**P<0.01

アルブミン漏出量

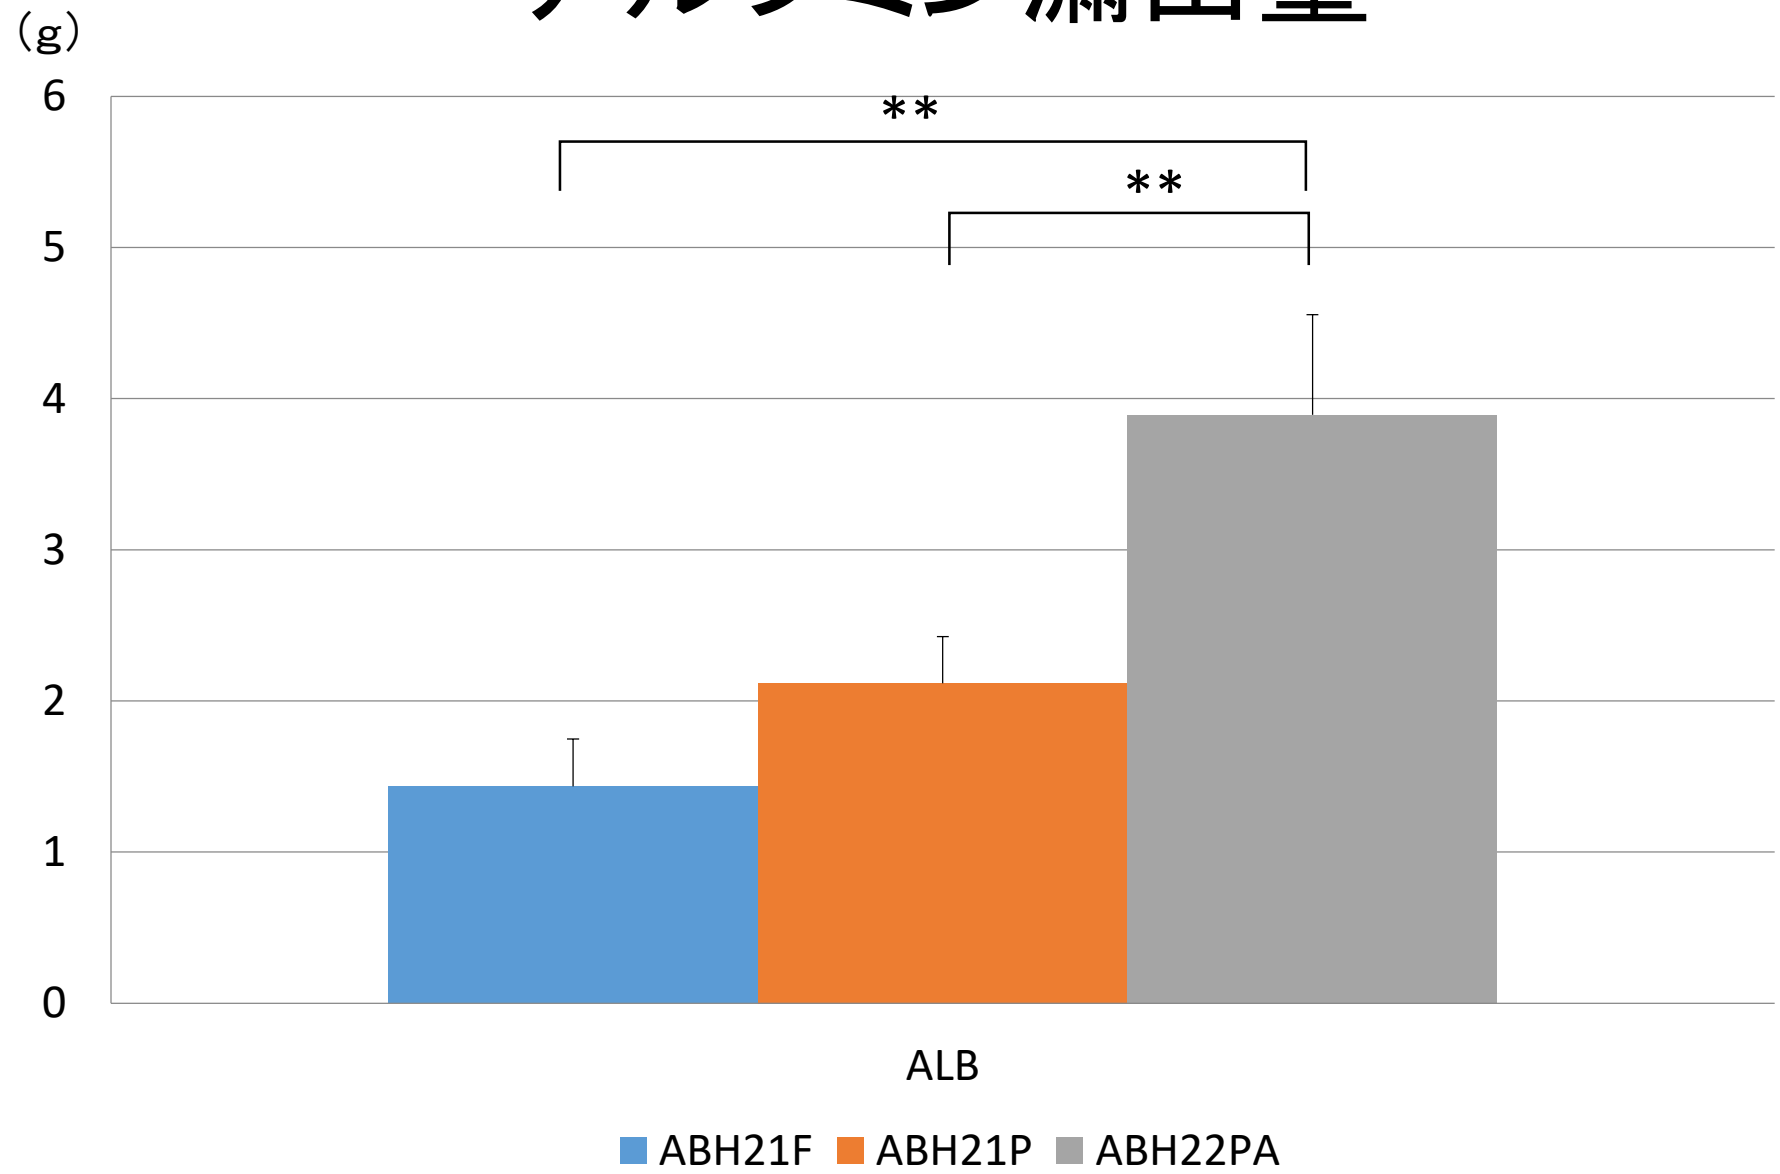

*P<0.05
**P<0.01

β2MG，α1MGクリアスペース

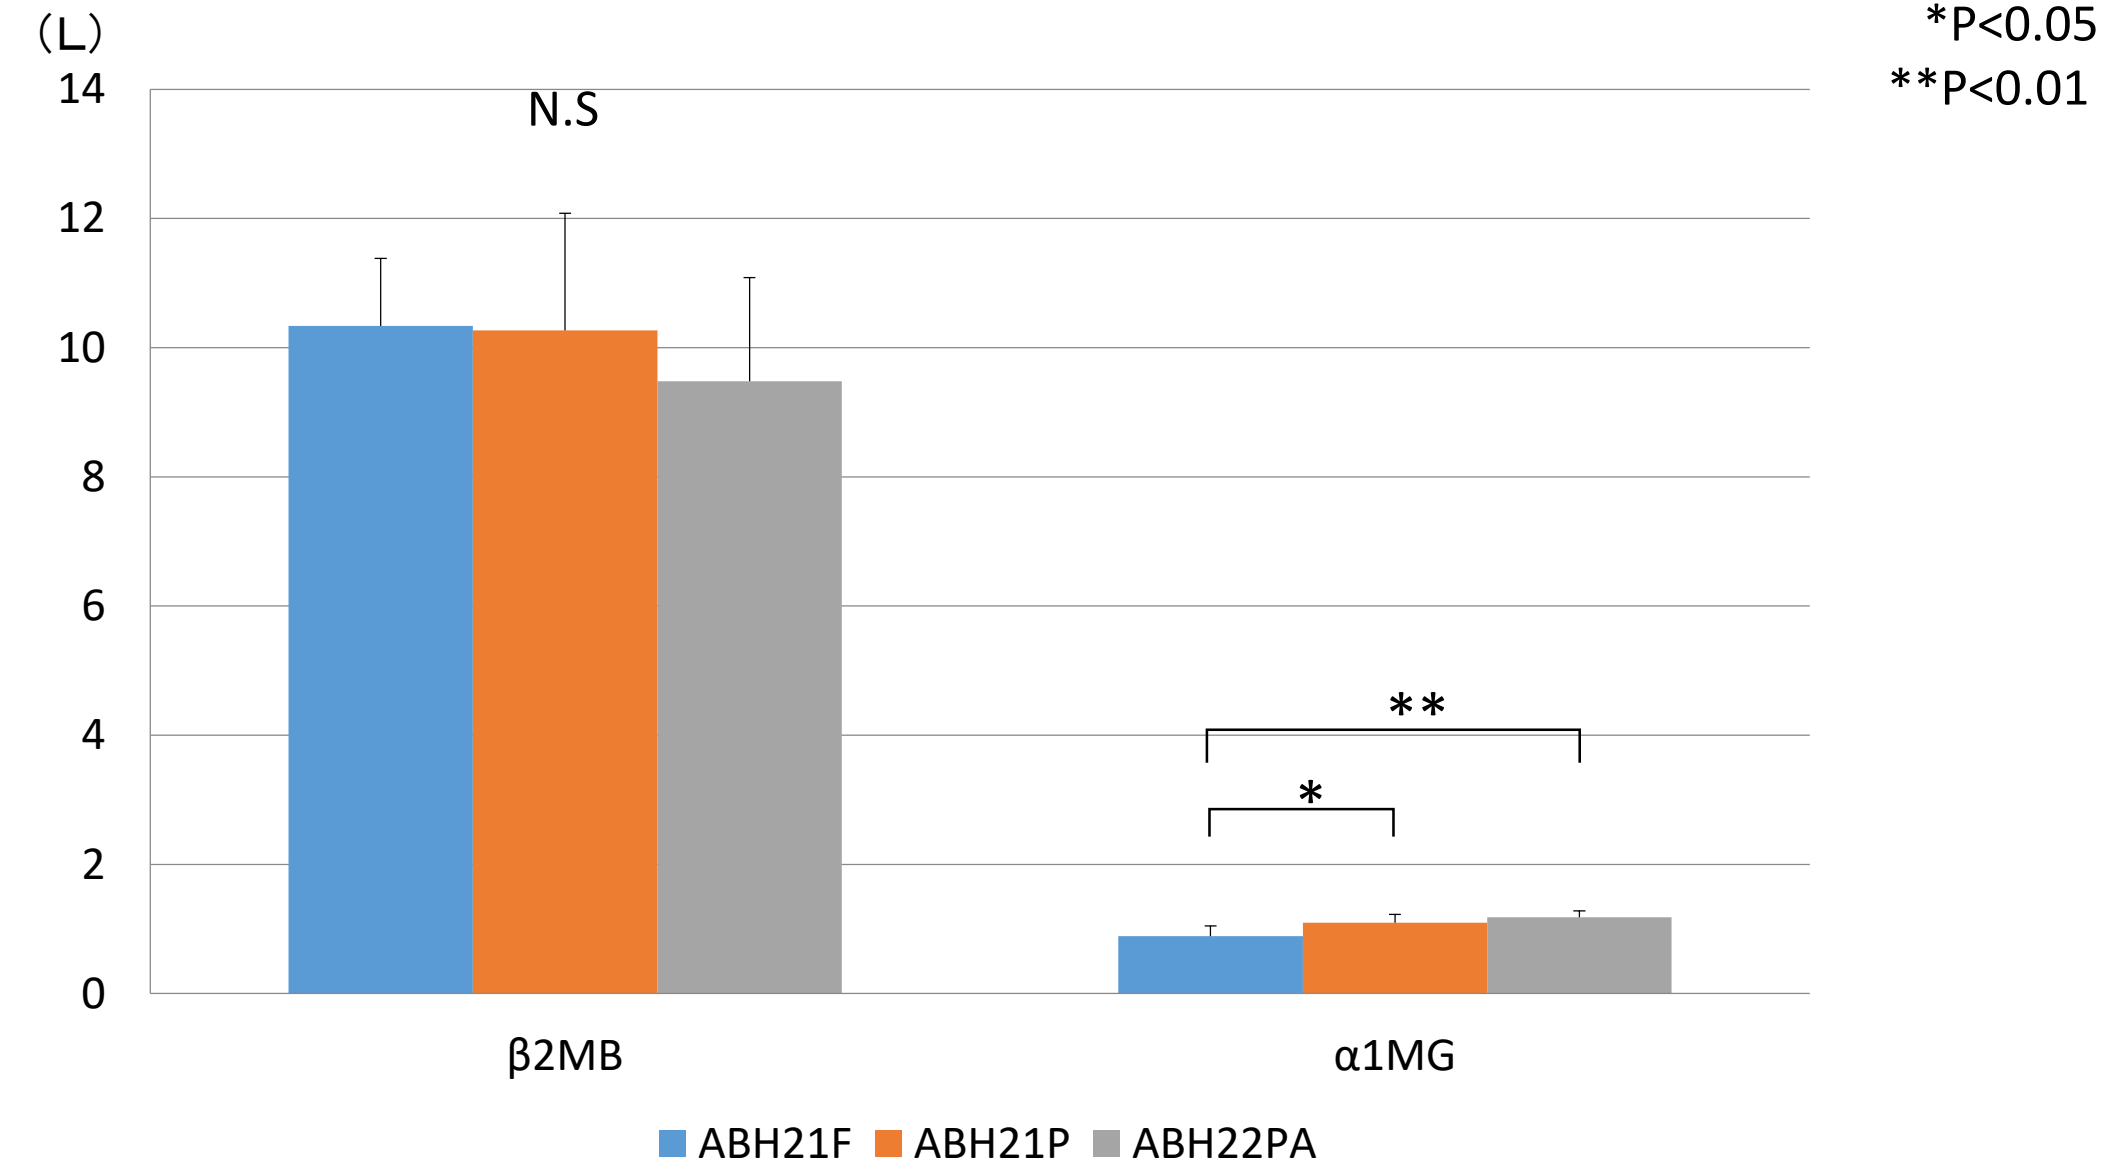

TMP

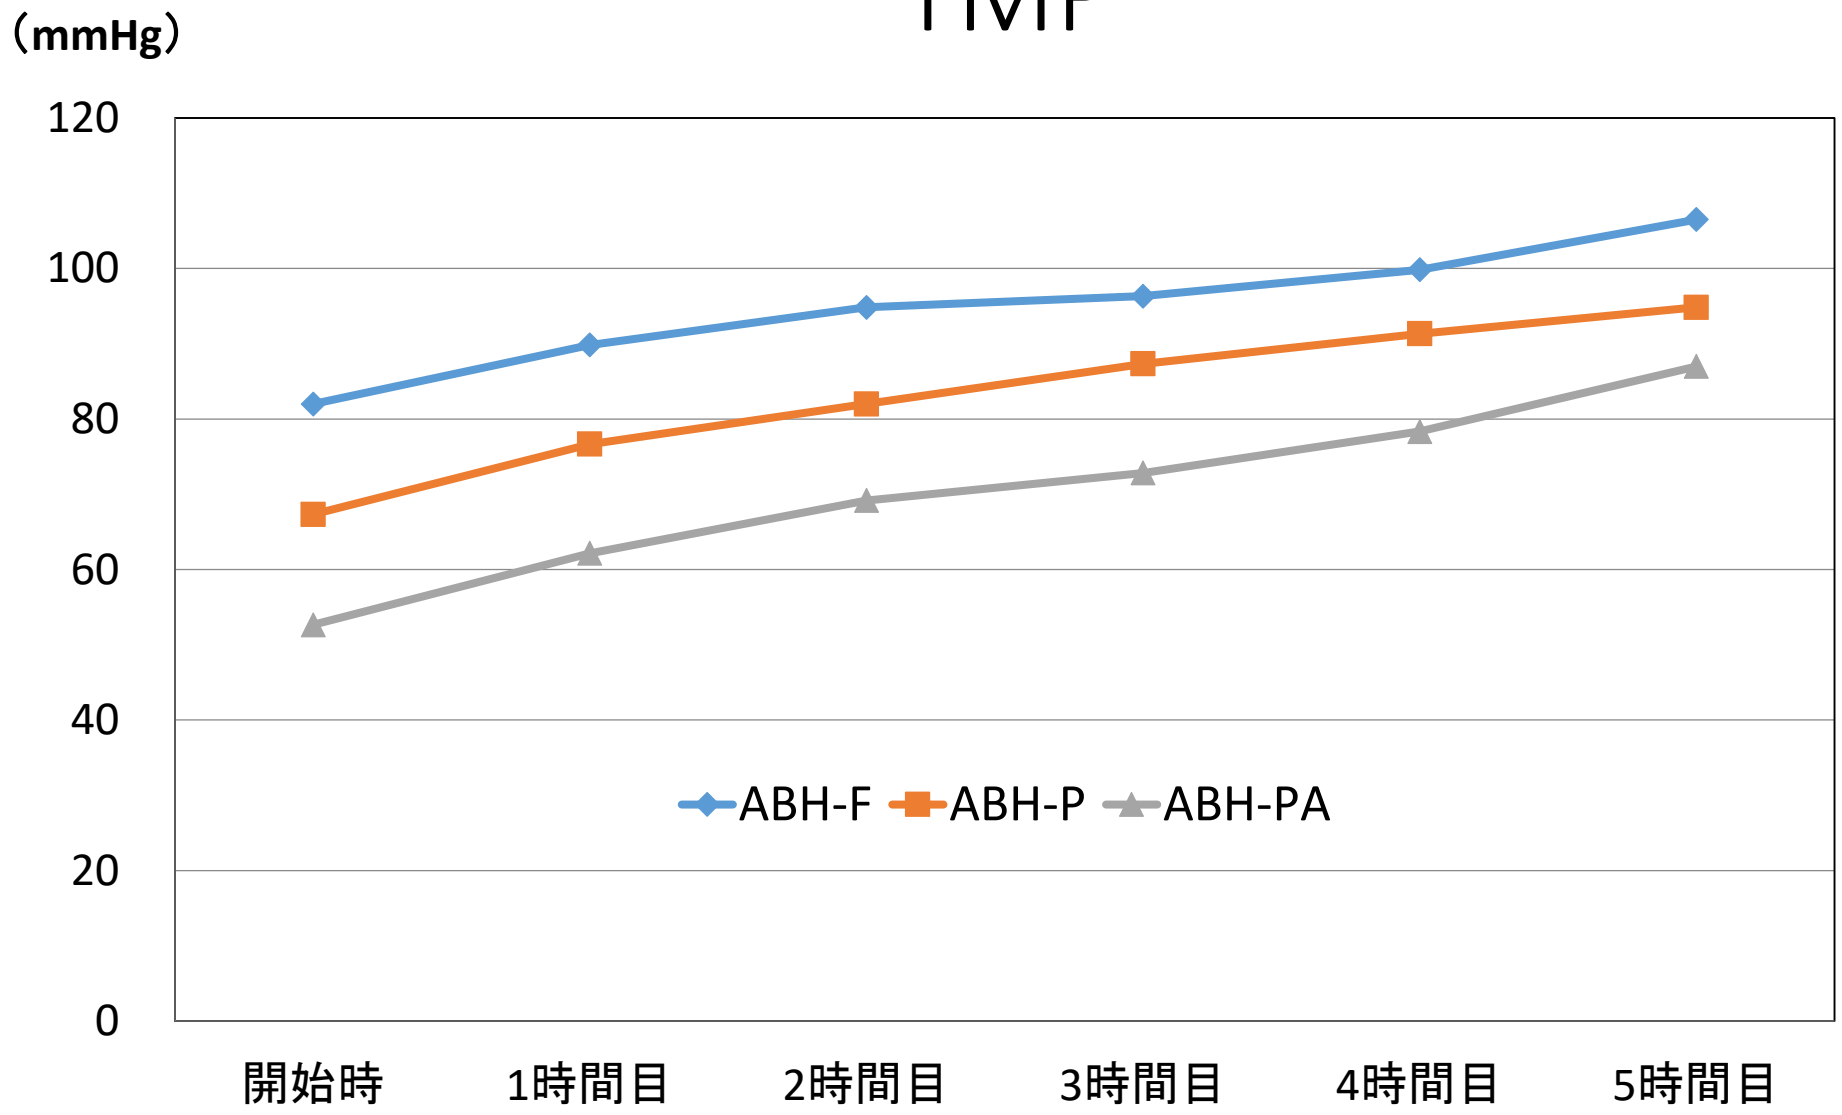
（mmHg）
120
100
80
60
40
20
0
ABH-F
ABH-P
ABH-PA
開始時
1時間目
2時間目
3時間目
4時間目
5時間目